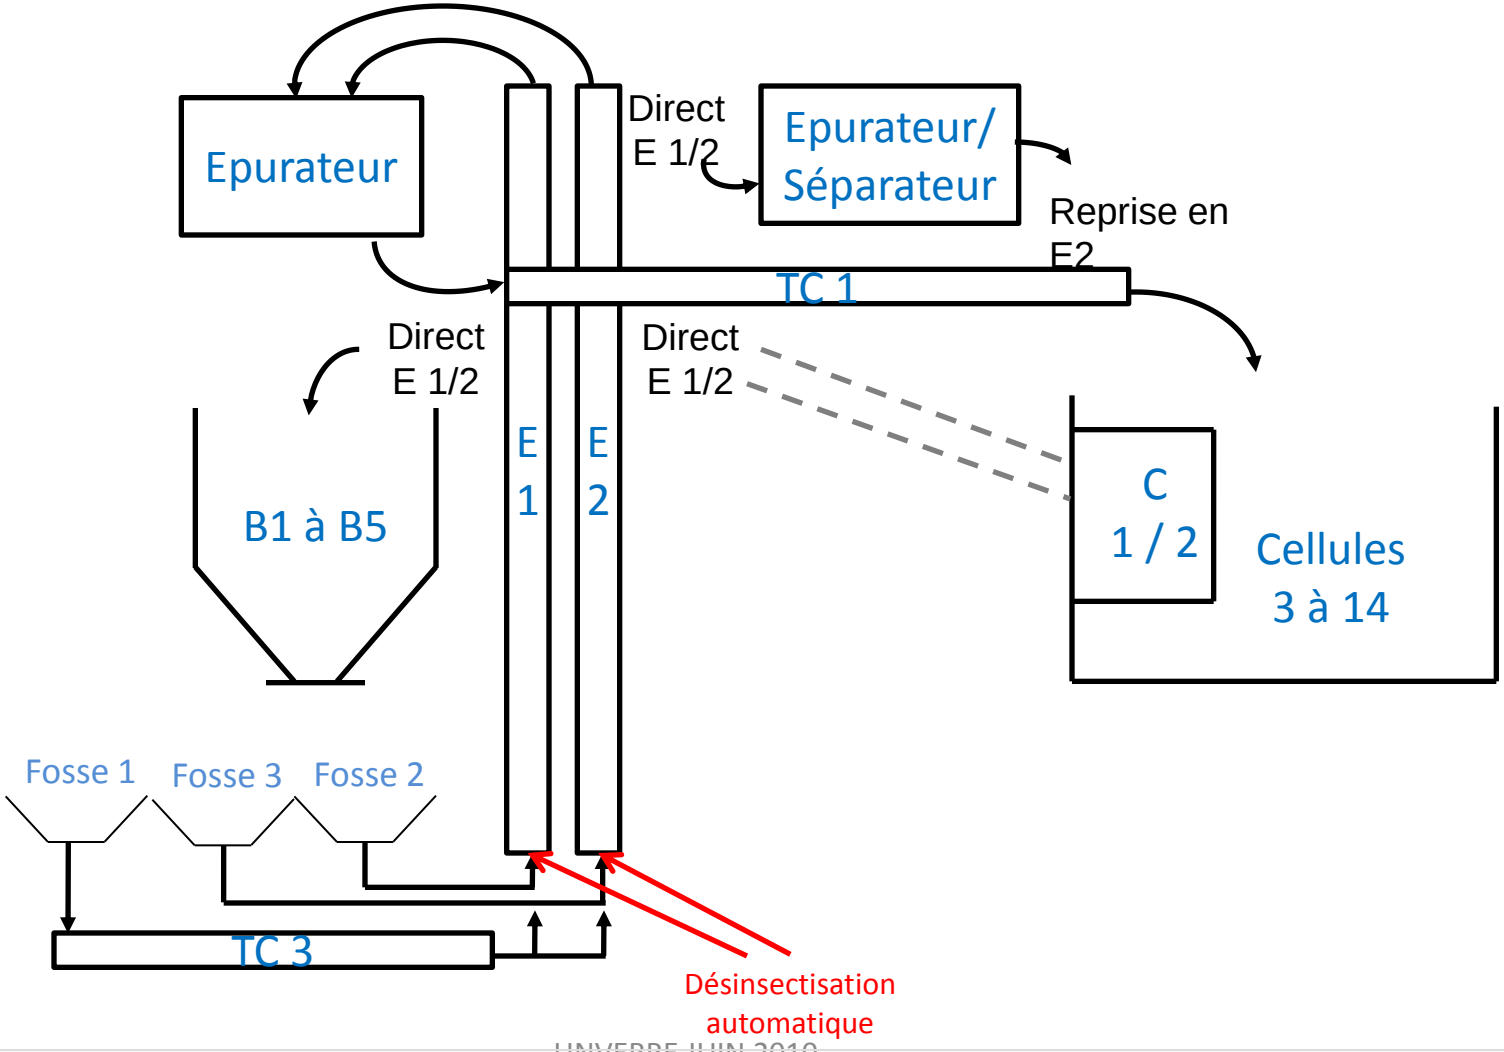

AQ/SM/SMQ/FORMULAIRESGRAINS/EN8.5-5-1ptt/07.17_Seule la version en ligne est en diffusion contrôlée par le service qualité. Merci de détruire les éventuelles versions papiers existantes dès la réception d'une nouvelle version.

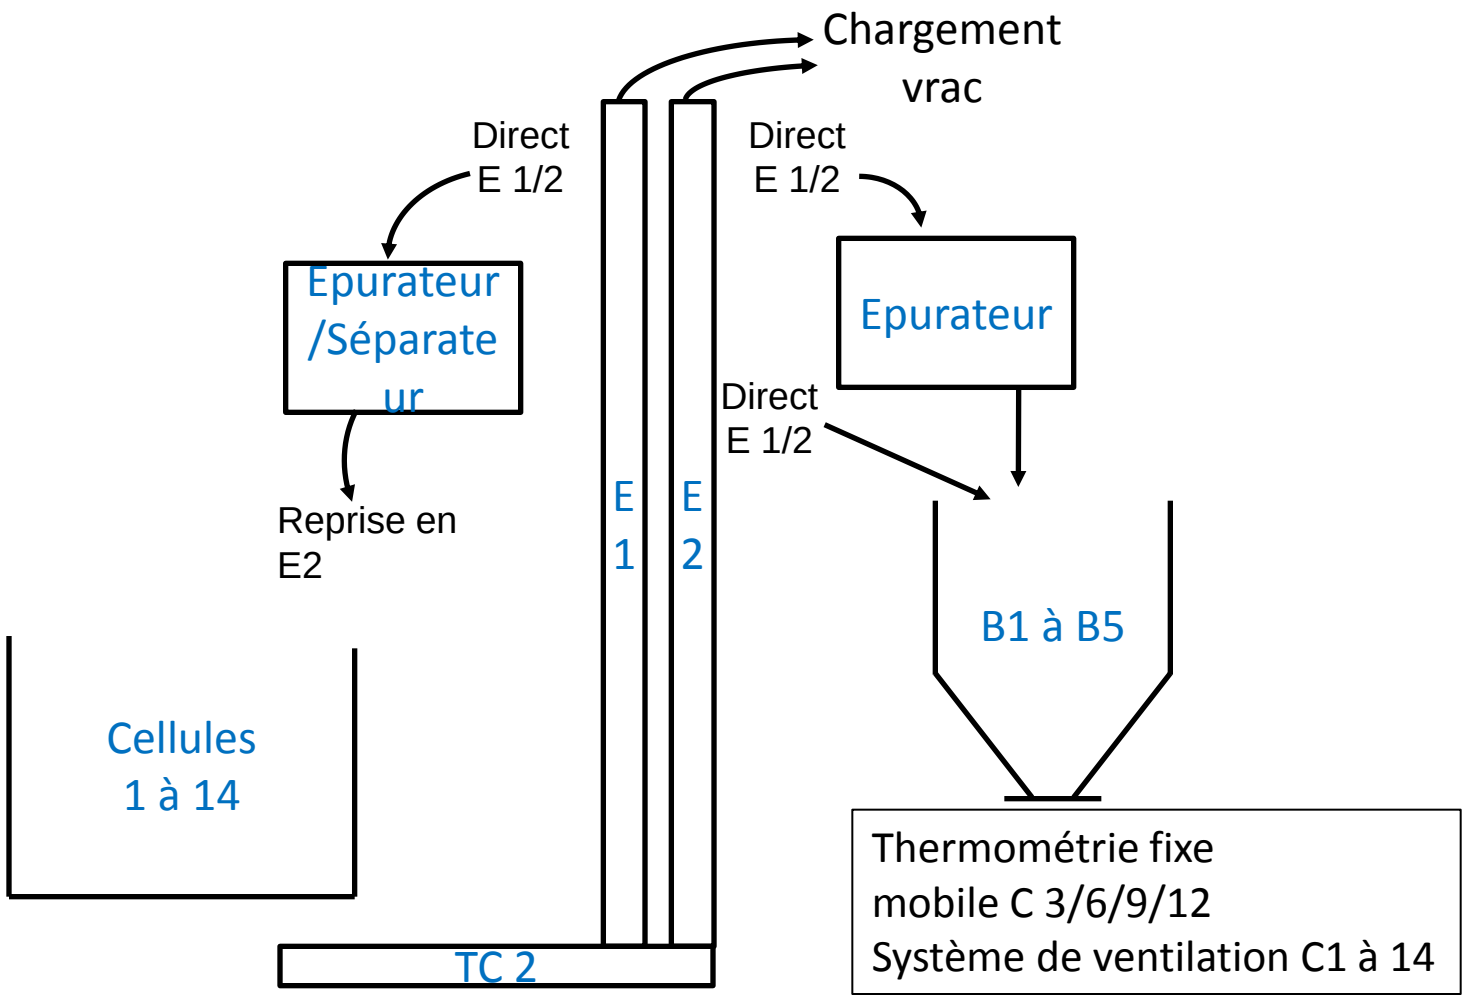
Chargement vrac
Direct E 1/2
Direct E 1/2
Epurateur /Séparateur
Epurateur
Direct E 1/2
Reprise en E2
E 1
E 2
B1 à B5
Cellules 1 à 14
Thermométrie fixe
mobile C 3/6/9/12
Système de ventilation C1 à 14
TC 2

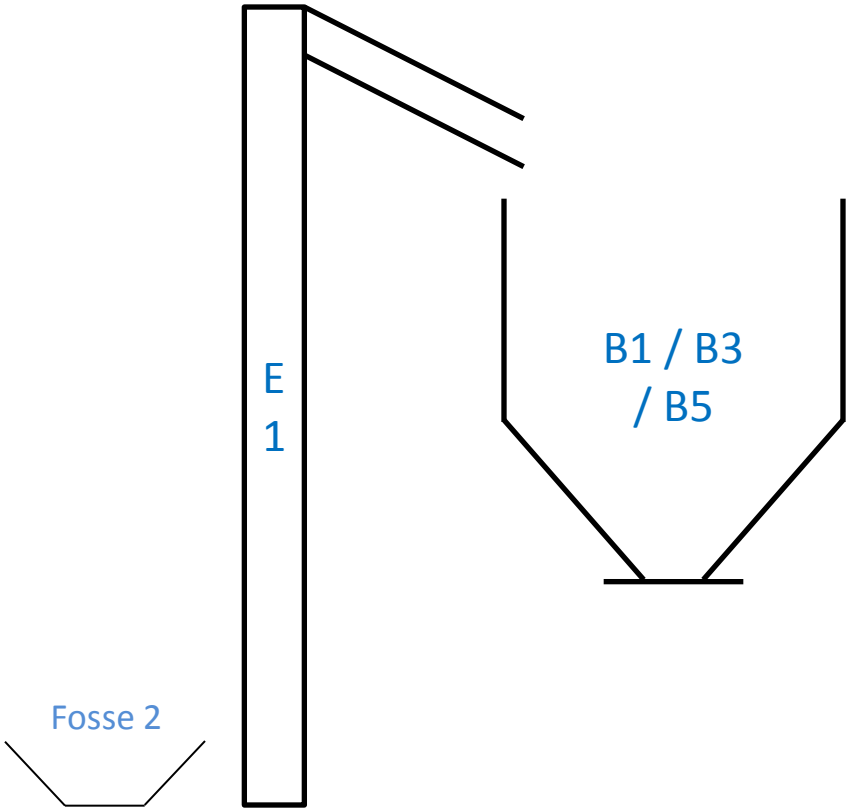

AQ/SM/SMQ/FORMULAIRESGRAINS/EN8.5-5-1ptt/07.17_Seule la version en ligne est en diffusion contrôlée par le service qualité. Merci de détruire les éventuelles versions papiers existantes dès la réception d'une nouvelle version.